

検査内容変更のお知らせ

(管理番号: 21-0025)
2021年2月 C-05

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび下記項目につきまして、測定機器を同一メーカーの後継機に変更させていただきますので、取り急ぎご案内申し上げます。
誠に勝手ではございますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具


記

■ 変更内容

	新	旧
項目コード	494	同左
検査項目名	尿素呼気試験	同左
測定機器名	赤外分光分析装置 POConePlus	赤外分光分析装置 POCone
機器メーカー	大塚電子株式会社	同左

※ 測定方法、基準値など、その他検査要項に変更はございません。

■ 新旧測定機の相関

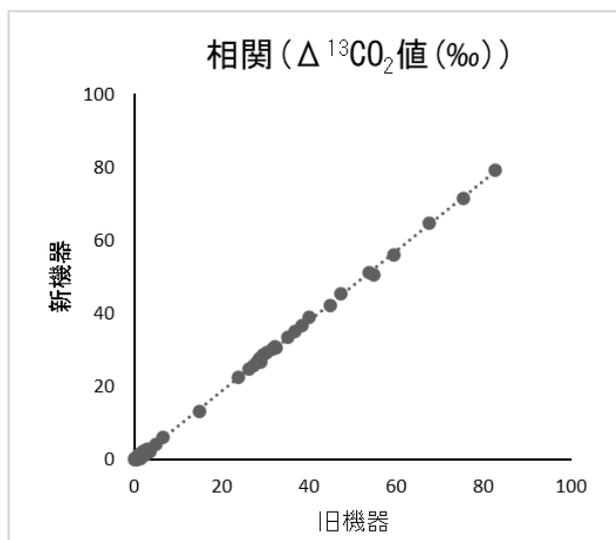

x: 旧機器 (POCone)
y: 新機器 (POConePlus)
回帰直線式
 $y=0.9576x-0.2599$
相関係数
 $r=0.9997$ (n=50)

(自社検討資料)

■ 变更日期

2021 (R3) 年4月1日(木) ご依頼分より