

# 検査内容変更のお知らせ

(管理番号: 21-0042)  
2021年5月 C-03

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
このたび下記項目につきまして、測定試薬を同一メーカーの改良試薬に変更させていただきますので、取り急ぎご案内申し上げます。  
誠に勝手ではございますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具


記

## ■ 変更内容

	新	現
項目コード	457	同左
検査項目名	CH50<血清補体価>	同左
測定試薬名	オート CH50-L「生研」Ⅱ	オート CH50-L「生研」
試薬メーカー	デンカ株式会社	同左

※ 測定方法、基準値など、その他検査要項に変更はございません。

## ■ 現試薬と新試薬の比較

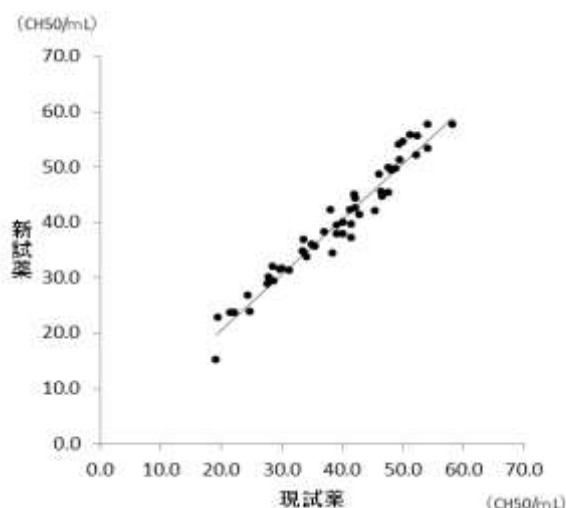

x : 現試薬 (オート CH50-L「生研」)  
y : 新試薬 (オート CH50-L「生研」Ⅱ)

回帰直線式

$$y = 1.0034 x + 0.567$$

相関係数

$$r = 0.9748 \quad (n=50)$$

(自社検討資料)

## ■ 変更期日

2021 (R3) 年5月24日(月)ご依頼分より