

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび多項目自動血球分析装置の機器老朽化に伴い、同一メーカーの後継機に変更させていただきますので、取り急ぎご案内申し上げます。
誠に勝手ではございますが、何卒ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

■ 変更内容

	新	旧
項目コード /検査項目名	601 / 末梢血液一般	同左
	631 / 末梢血液像5分類	同左
	651 / 網赤血球数	同左
機器メーカー	シスメックス株式会社	シスメックス株式会社
測定機器名	多項目自動血球分析装置 XN-10	多項目自動血球分析装置 XE-5000

※検査方法、基準値などその他検査要項に変更はございません。









その他詳細につきましては弊社担当セールスにお尋ねください。

■ 変更期日

2021 (R3) 年5月6日(木) ご依頼分より






【現測定機・新測定機の相関】

●末梢血液一般

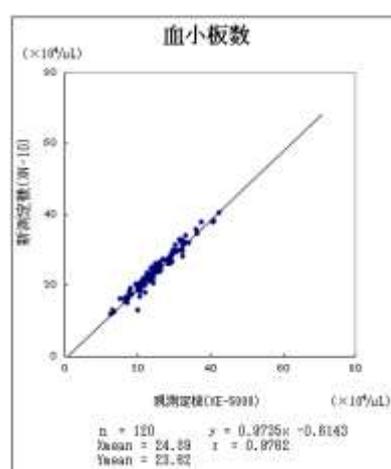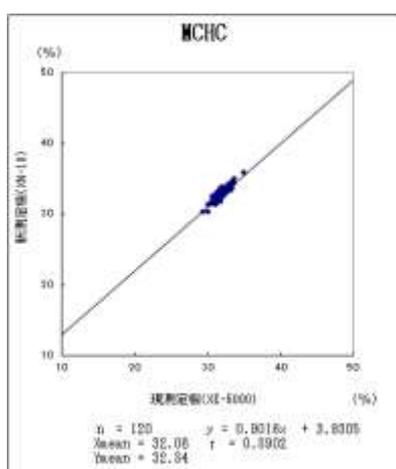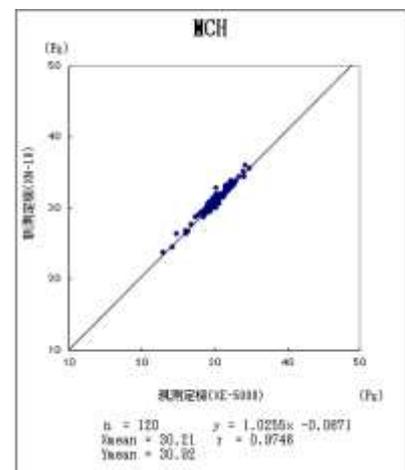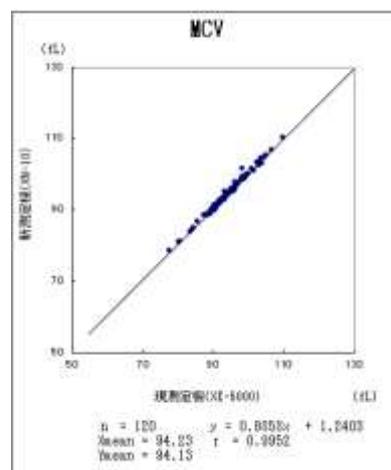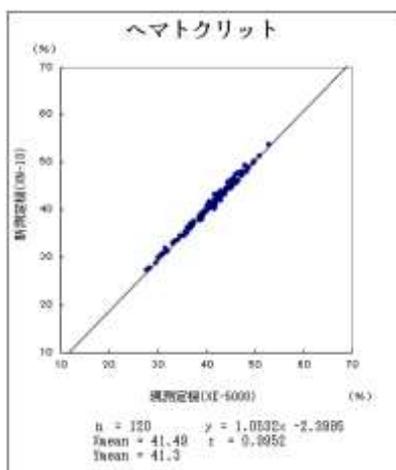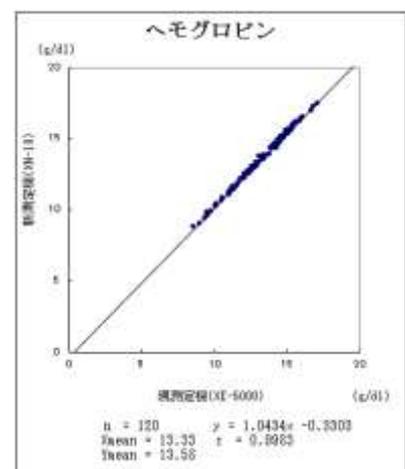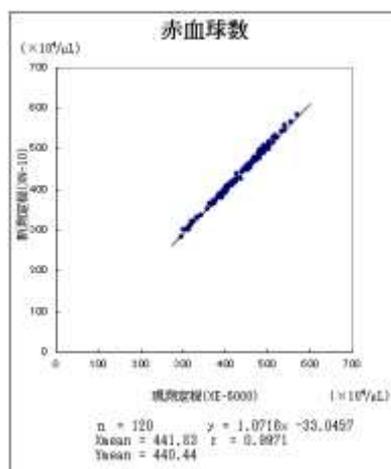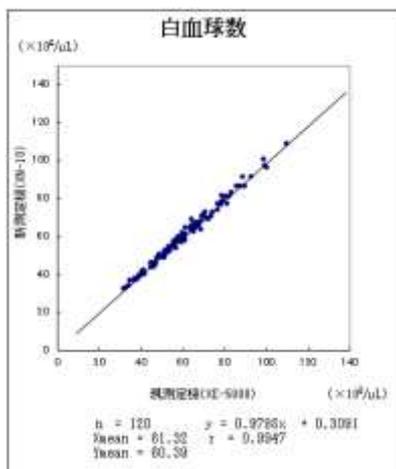

【現測定機・新測定機の相関】

●末梢血液像5分類

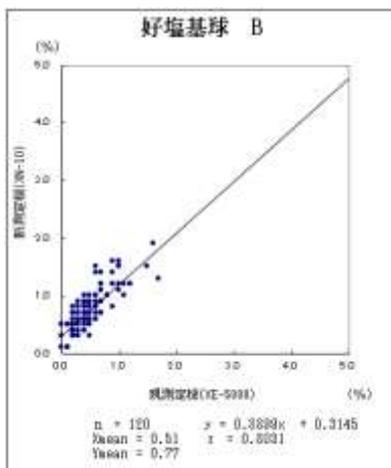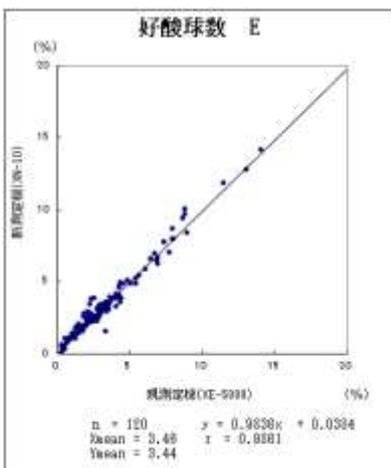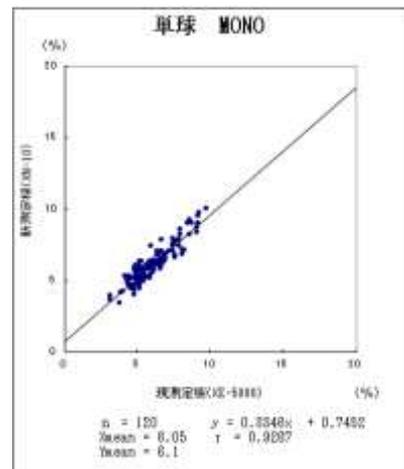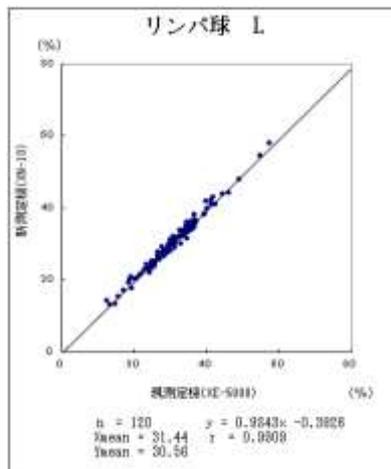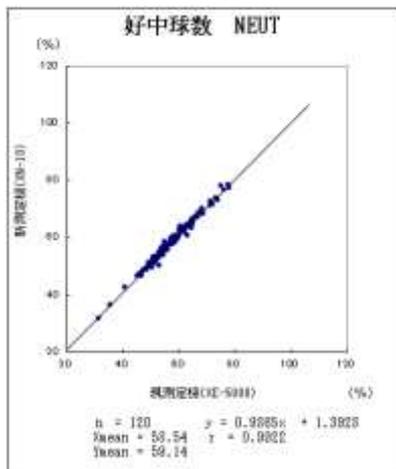

●網赤血球数

