

検査内容変更のお知らせ

(管理番号: 22-0002)
2022年3月 C

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび下記項目につきまして、現行試薬の販売中止に伴い、同一メーカーの改良試薬に変更させていただきますので、取り急ぎご案内申し上げます。
誠に勝手ではございますが、何卒ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具


記

■ 変更内容

	新	現
項目コード	419	同左
検査項目名	HCV抗体-Ⅱ	同左
測定試薬名	C型肝炎ウイルス抗体キット HCV Ab・アボット	C型肝炎ウイルス抗体キット HCV・アボット
試薬メーカー	アボットジャパン合同会社	同左

※ 測定方法、基準値など、その他検査要項に変更はございません。

■ 現行試薬と新試薬の相関

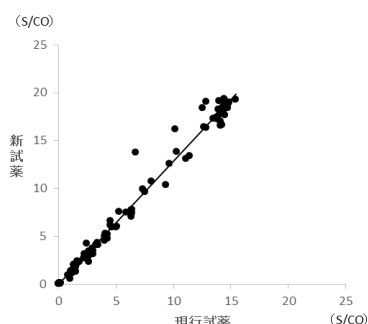

x : 現行試薬 (HCV・アボット)

y : 新試薬 (HCVAb・アボット)

回帰直線式 $y = 1.2897x - 0.0289$

相関係数 $r = 0.9922$ (n=100)

(自社検討資料)

■ 判定一致率

		現行試薬		計
		陽性(+)	陰性(-)	
新試薬	陽性(+)	74	0	74
	陰性(-)	1	25	26
計		75	25	100

陽性一致率 : 98.7% (74/75)

陰性一致率 : 100.0% (25/25)

判定一致率 : 99.0% (99/100)

(自社検討資料)

■ 変更期日

2022 (R4) 年4月1日(金) ご依頼分より