

検査内容変更のお知らせ

(管理番号:22-0120)

2022年09月 C-02

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび下記項目につきまして、測定機器を変更させていただきますので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

■ 対象項目

項目コード	検査項目名
0371	尿)ナトリウム
0372	尿)クロール
0373	尿)カリウム
0381	蓄尿)ナトリウム
0382	蓄尿)クロール
0383	蓄尿)カリウム
0984	髄液)ナトリウム
0985	髄液)クロール
0986	髄液)カリウム

■ 変更日




2022(R4)年10月11日(火) ご依頼分より

■ 検査要項

	新	旧
項目コード	0371 0372 0373 0381 0382 0383 0984 0985 0986	同左
検査項目名	尿)ナトリウム 尿)クロール 尿)カリウム 蓄尿)ナトリウム 蓄尿)クロール 蓄尿)カリウム 髄液)ナトリウム 髄液)クロール 髄液)カリウム	同左
検査方法	イオン選択電極法	同左
測定機器	BM8060(日本電子 株式会社)	EA07(株式会社 エイアンドティー)

* その他検査要項の変更はございません。

■ 新旧相関

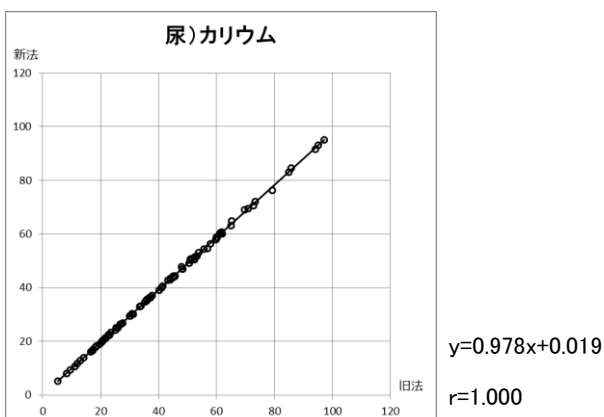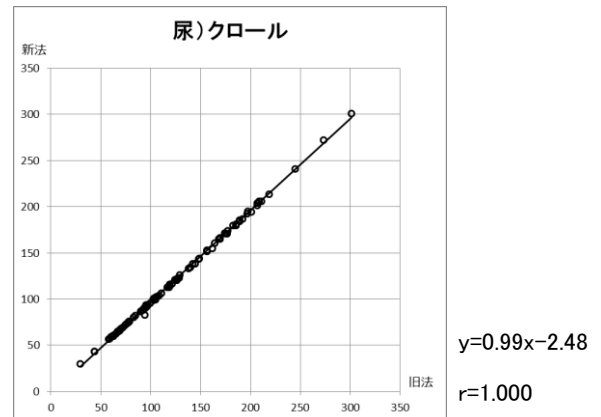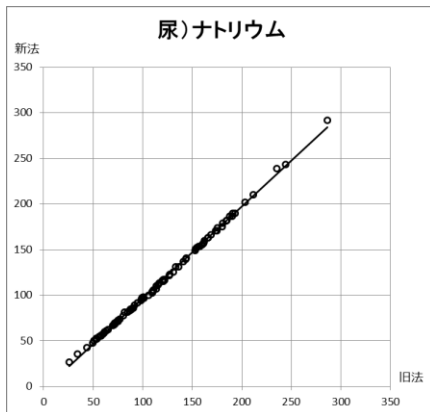

(自社検討資料)